Bestellschein Alpha DESIGN® Liner Neu-Scan

E-Mail: bestellungen@teufel-international.com, Fax: +49 (0) 7161 15684-333

WJT ORTHO

Firma:

Kunden-Nr.:

Lieferadresse:

PLZ, Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

Kundenstempel:

E-Mail:

Anwender, ID-Nr.:

Gescannt am:

Gewicht in kg:

Gescannt durch:

Aktivitätsgrad:

Design-Liner Spezifikation

Seite: ☐ Links ☐ Rechts

TF/TT: ☐ Oberschenkel (TF) Umfang (distal 30cm): _____ ☐ Unterschenkel (TT) Umfang (distal 40cm): _____

Adaption: ☐ Cushion ☐ Locking (Standardtasse) ☐ Locking (optionale Tasse) _____ (in inch, siehe Rückseite)

Größe: ☐ S ☐ S+ ☐ M ☐ M+ ☐ M+Wide ☐ L ☐ L+ ☐ XL ☐ XL+

☐ Hybrid-Gel

Select-Textur in Grau, TT mit Kniepanel

☐ Soft-Silicone (Express-Liner)

Select-Textur in Graubraun,
TT mit Kniepanel
ACHTUNG nur in den Größen M, M+, L

☐ Classic-Gel / Silicone (DUO Liner)

Ohne Textur, in Dunkelgrau

☐ Classic-Gel

Textur

- ☐ Original
- ☐ Spirit (klettfähig)
- ☐ MAX
- ☐ Select, TT mit Kniepanel

Farbauswahl

- ☐ Grün/Grau
- ☐ Grün/Grau Hellbraun
- ☐ Hellbraun Grau
- ☐ Hellbraun

☐ Der Design-Liner wurde in meinem Beisein bzw. im Beisein meiner Mitarbeiter modelliert. Die Modellierung und die Eigenschaften von Material (Classic-Gel, Hybrid-Gel, Soft-Silicone) und Textur wurden mir ausführlich erklärt.

☐ Ich wurde darüber informiert, dass der Design-Liner eine Individualanfertigung für den oben genannten Anwender ist. Als solche kann ein Design-Liner nur bei qualitativen Mängeln zurückgenommen werden. Ein Umtausch aus sonstigen Gründen ist ausgeschlossen.

☐ Ich wurde darüber informiert, dass die zur Herstellung verwendeten Rohmaterialien den Anforderungen der MDR 2017/745 entsprechen. Da es sich um eine Individualanfertigung für den oben genannten Anwender handelt, ist der Auftraggeber im Sinne des MPDG und der MDR für die entsprechende Dokumentation verantwortlich. Der maßangefertigte Design-Liner ist singulär kein Medizinprodukt, sondern wird entsprechend seiner Zweckbestimmung durch den vorgesehenen Einsatz in einer Sonderanfertigung Prothese zu einem Zubehör dieses Medizinprodukts.

⚠ **Eventuelle Reklamationen bezüglich der Passform sind 30 Tage nach Anprobe aber spätestens 60 Tage nach Erhalt anzumelden.**

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass der Design-Liner erst nach dem Eingang dieses Faxbestellscheins im Firmensitz in Wangen bei WillowWood bestellt wird. Nach Eingang Ihres Auftrags senden wir Ihnen umgehend eine Auftragsbestätigung zu. Die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Wochen nach Auftragseingang in Wangen. **Bitte beachten Sie, dass nach jedem neu gescannten Design-Liner ein neuer Schaft erforderlich ist.**

Datum | Ansprechpartner (Druckschrift) | Unterschrift

Verfügbare Linertassen

Tassendurchmesser					
Linergröße	**P-Pod - 1 1/8“ (2,9 cm)**	**S - 1 5/8“ (4,1 cm)**	**M - 2 3/4“ (7 cm)**	**XXL - 3 3/4“ (9,5 cm)**	**XXXL - 4 1/2“ (11,4cm)**
Small		Standard			
Small Plus		Standard			
Medium		Optional*	Standard		
Medium Plus		Optional*	Standard		
Medium Plus Wide			Standard	Optional	
Large			Standard	Optional	Optional
Large Plus			Standard	Optional	Optional
Extra Large			Standard	Optional	Optional
Extra Large Plus			Standard	Optional	Optional
Kinder	Standard				
Upper-Extremity	Optional	Optional			

* nur für Unterschenkel-Liner

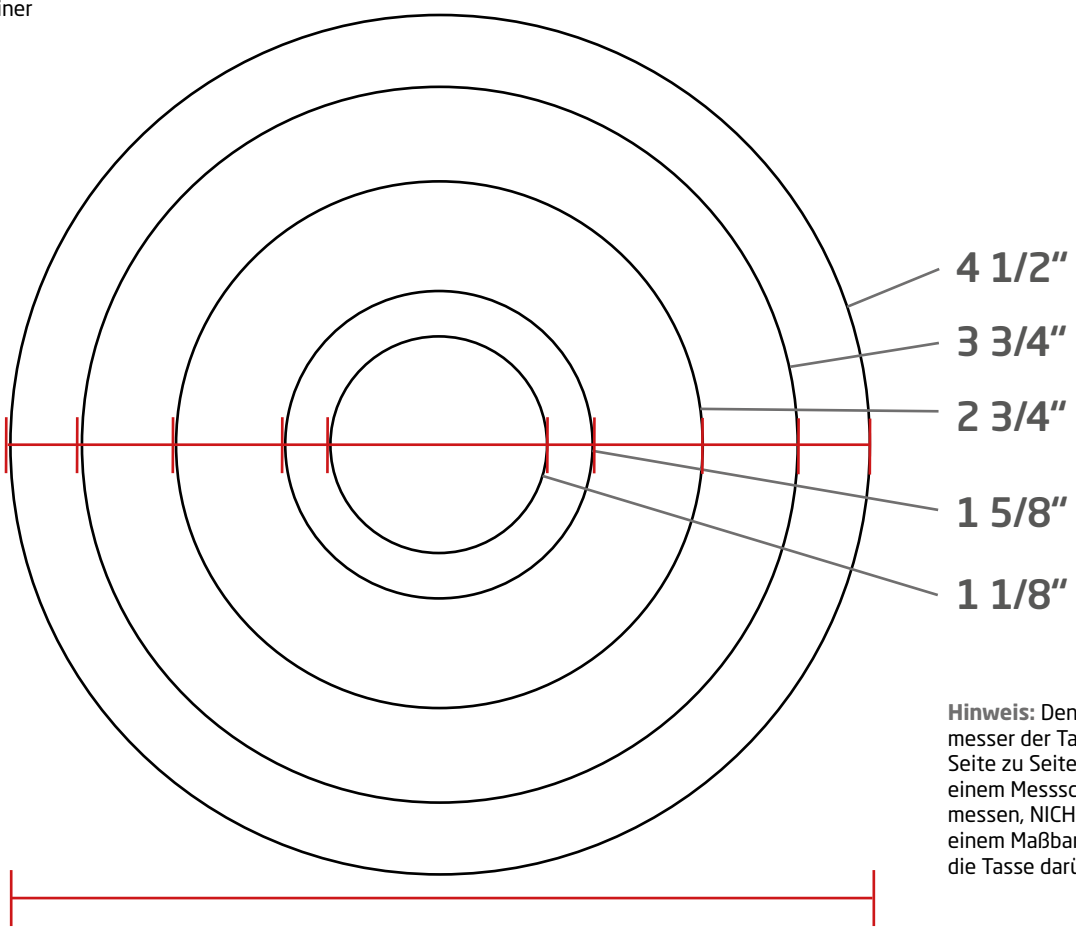

Hinweis: Den Durchmesser der Tasse von Seite zu Seite mit einem Messschieber messen, NICHT mit einem Maßband über die Tasse darüber.

Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

90.246.005.02 2023/12 © Wilhelm Julius Teufel GmbH