Maßblatt Co.Co.S.®

WJT ORTHO

Sanitätshaus/Lieferadresse: Kundennummer:

Ansprechpartner/Techniker: Telefonnummer: E-Mail:

Wunschliefertermin:

Patientendaten

Name: IdentNr.: ☐ Weiblich ☐ Männlich

Alter: Gewicht: Körpergröße: Aktivitätsgrad: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Amputationsseite: ☐ links ☑ rechts

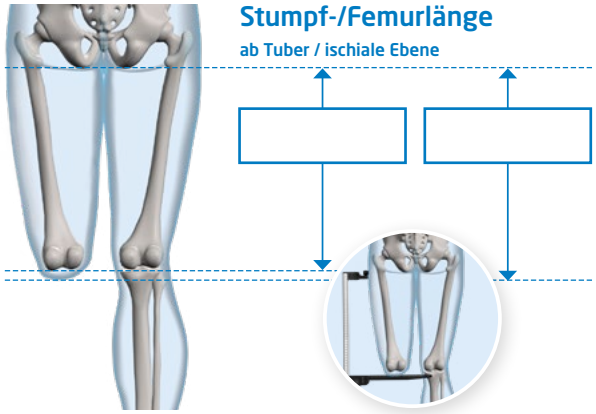

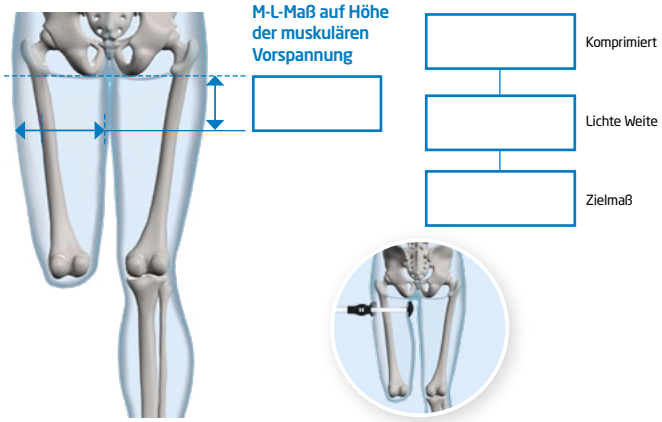

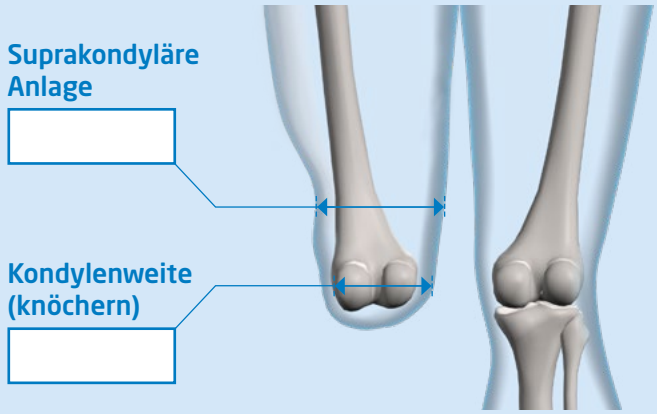

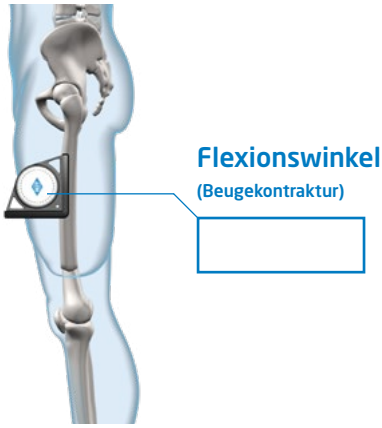

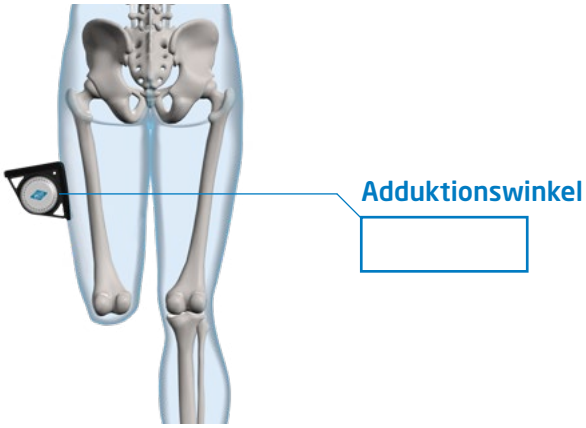

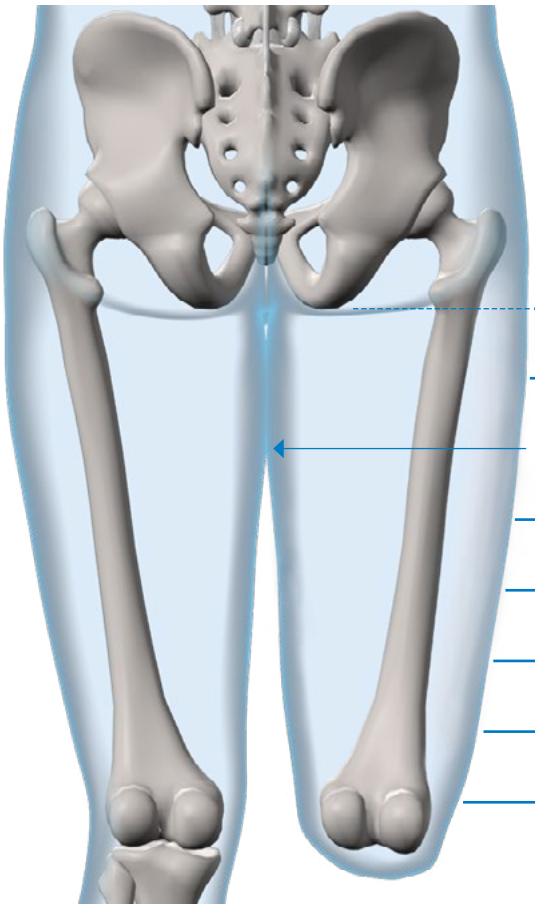

Umfangsmaße und Reduktionstabelle

	Umfang (in cm)	Reduzierung (in %)	Reduzierung (in cm)	Zielmaß (in cm)
+8 cm	cm	0 %	cm	cm
+4 cm	cm	2 %	cm	cm
M-L Maß = 0	cm	4 %	cm	cm
-4 cm	cm	3 %	cm	cm
-8 cm	cm	2 %	cm	cm
-12 cm	cm	1 %	cm	cm
-16 cm	cm	0 %	cm	cm
-20 cm	cm	0 %	cm	cm

Modellierschritte

- ☐ 1. Höhenmaße setzen
- ☐ 2. laterale Anlage gestalten
- ☐ 3. M-L Weite auf Zielmaß bringen
- ☐ 4. Kondyläres Maß anpassen
- ☐ 5. Suprakondyläres Maß anpassen
- ☐ 6. Gesamtreduzierung

Liner- / Profilauswahl



☐ Alpha Symmetrical TF-Liner



☐ Alpha DESIGN® Liner



☐ Alpha TruSeal TF-Liner



☐ Alpha Silicone® TF-Liner



☐ Alpha DUO® TT/TF-Liner



☐ One System SmartTemp® TF-Liner



☐ Alpha SmartTemp® Silicone TF-Liner



☐ Alpha SmartTemp® Gel TF-Liner

Linergröße: _____

LimbLogic® Kniekappe Größe: _____

Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

90.396.331.00 Rev. 2024/04 © Wilhelm Julius Teufel GmbH